

## 補装具費支給意見書（ 交付・修理 ）


受 付	令和      年      月      日												
氏 名	大正 昭和 平成 令和      年      月      日 (満      才)	手帳 等級	級	手帳 番号									
		障 害 名											
住 所													
傷病名	*特殊の疾病（難病等）に該当    (□する・□しない)												
現 症	*聴覚障害、視覚障害については裏面も記入してください。 *難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動等についても記入してください。												
補装具名 又は 修理部位													
補装具の 処方内容 及び 工作的所見	<p>*補聴器の処方内容・装用耳について、下記より選択してください。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">処方内容</td> <td style="width: 25%;">高度難聴用</td> <td style="width: 25%;">ポケット型</td> <td style="width: 25%;">イヤモールドつき</td> </tr> <tr> <td></td> <td>重度難聴用</td> <td>耳かけ型</td> <td>イヤモールドなし</td> </tr> </table> <p>*その他記載事項 (車椅子・重度障害者用意思伝達装置の場合、希望の型式、必要な付属品を記入して下さい。)</p>					処方内容	高度難聴用	ポケット型	イヤモールドつき		重度難聴用	耳かけ型	イヤモールドなし
処方内容	高度難聴用	ポケット型	イヤモールドつき										
	重度難聴用	耳かけ型	イヤモールドなし										
補装具使用 による 効果見込み													
<p>上記のとおり意見する。</p> <p>令和      年      月      日</p> <p>病院又は診療所名 所 在 地 診療担当科名 作成医師氏名</p>													

- \*この意見書が使用できるのは、補聴器（ポケット型・耳かけ型の福祉対応機種）、重度障害者用意思伝達装置、眼鏡、車椅子です。
- \*車椅子（オーダーメイド）の場合は、申請された方が、歩行困難等の理由により障がい者相談支援センターで医学的判定を受けられない場合のみ使用してください。（別紙処方箋を添付すること。）
- \*車椅子（意見書による支給申請）については、意見書を作成した医師により適合判定を行ってください。

(記入上の注意)

補装具の種目が、補聴器、眼鏡である場合は、検査値を記入してください。

1 聴力

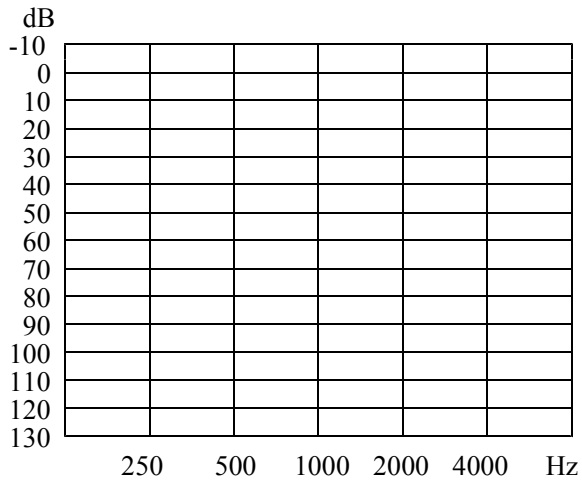

・聴力検査結果（4分法）

	右	Hz	左	
		500		
		1000		
		2000		



・語音明瞭度（検査している時には記入してください）

右		%
左		%

2 視力

	裸眼	矯	正
右		( × DCyl DAx )	
左		( × DCyl DAx )	

3 視野

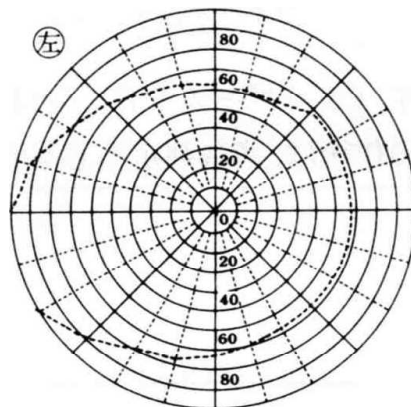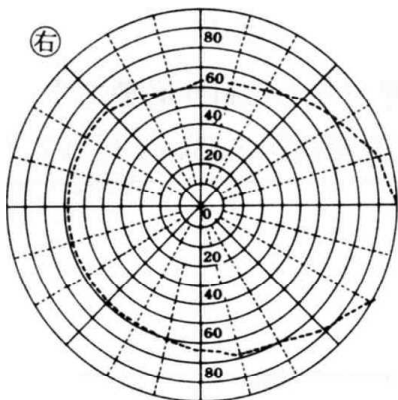

4 瞳孔間距離

( mm)

## 補装具費支給意見書（ 交付・修理 ）

受 付	令和      年      月      日				
氏 名	大正 昭和 平成 令和      年      月      日 (満      才)	男 ・ 女	手帳 等級	級	手帳 番号
		障 害 名			
住 所					
傷病名	*特殊の疾病（難病等）に該当    (□する・□しない)				
現 症	*聴覚障害、視覚障害については裏面も記入してください。 *難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動等についても記入してください。				
補装具名 又は 修理部位					
補装具の 処方内容 及び 工作的所見	*補聴器の処方内容・装用耳について、下記より選択してください。 処方内容      高度難聴用      ポケット型      イヤモールドつき 重度難聴用      耳かけ型      イヤモールドなし *その他記載事項 (車椅子・重度障害者用意思伝達装置の場合、希望の型式、必要な付属品を記入して下さい。)				
補装具使用 による 効果見込み					
上記のとおり意見する。 令和      年      月      日 病院又は診療所名 所 在 地 診療担当科名 作成医師氏名					


印

- \*この意見書が使用できるのは、補聴器（ポケット型・耳かけ型の福祉対応機種）、重度障害者用意思伝達装置、眼鏡、車椅子（オーダーメイド）です。
- \*車椅子（オーダーメイド）の場合は、申請された方が、歩行困難等の理由により障がい者相談支援センターで医学的判定を受けられない場合のみ使用してください。（別紙処方箋を添付すること。）
- \*車椅子（意見書による支給申請）については、意見書を作成した医師により適合判定を行ってください。

(記入上の注意)

補装具の種目が、補聴器、眼鏡である場合は、検査値を記入してください。

1 聴力

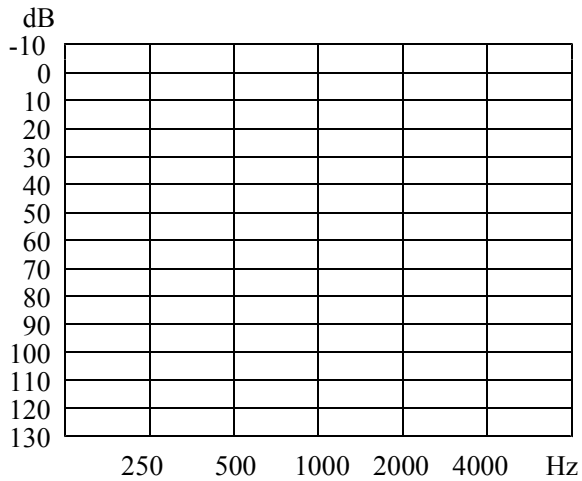

・聴力検査結果（4分法）

	右	Hz	左	
		500		
		1000		
		2000		



・語音明瞭度（検査している時には記入してください）

右		%
左		%

2 視力

	裸眼	矯	正
右		( × DCyl DAx )	
左		( × DCyl DAx )	

3 視野

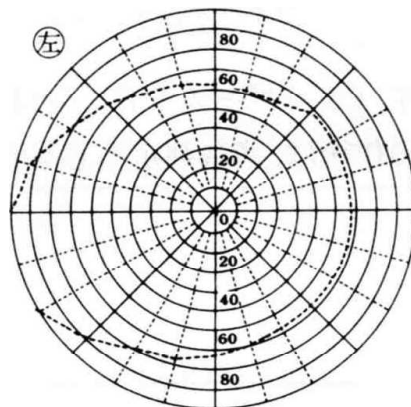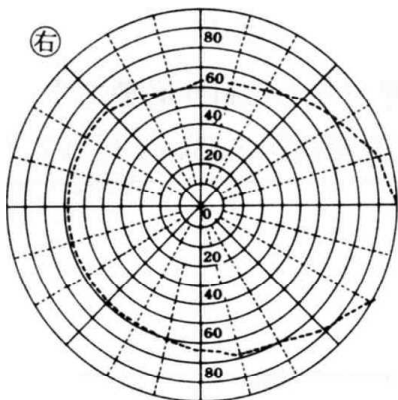

4 瞳孔間距離

( mm )